
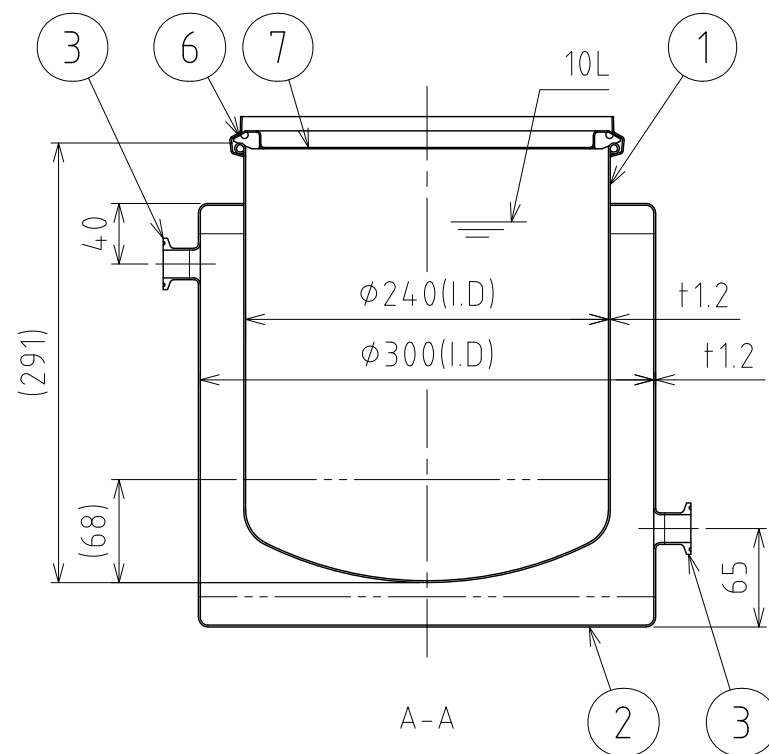
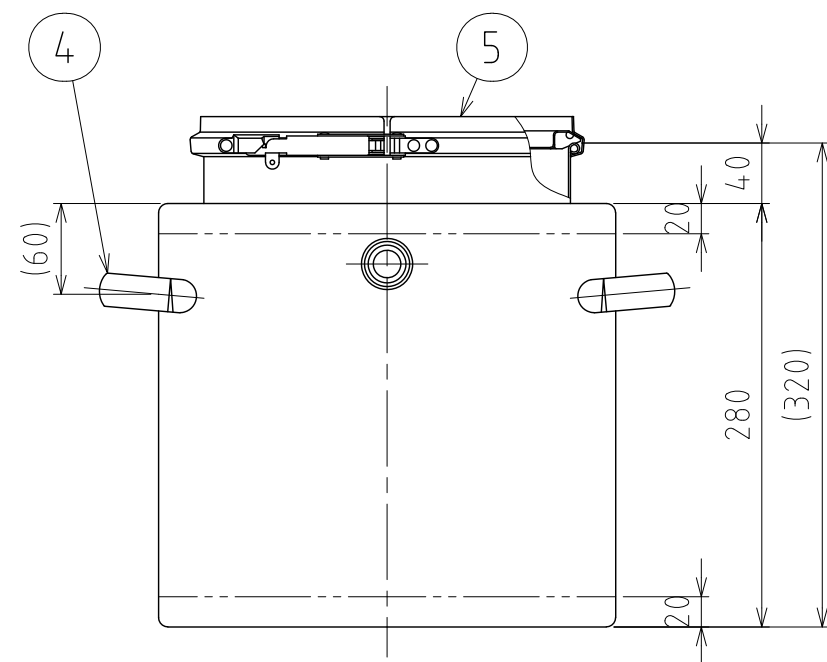
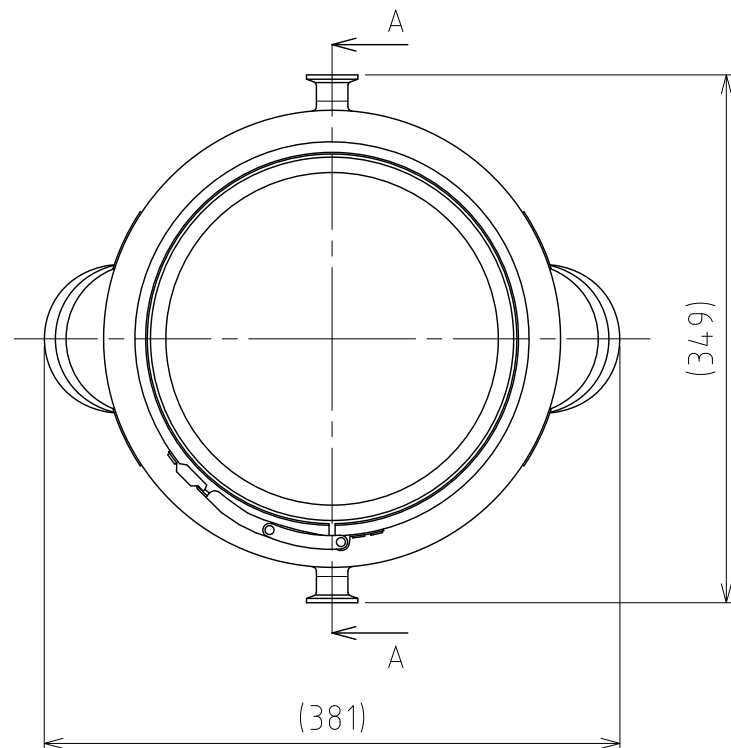




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R240×R24	SUS304	1	鏡板：4-005040
2	ジャケッ ト		SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
4	取っ手	S	SUS304	2	
5	レバーバンド	B-27	SUS304	1	
6	ガスケッ ト	LP-27	シリコンゴム	1	
7	密閉蓋	L-27 (±0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 10L
ジャケット 約8.2L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

3	MARK		DATE		REV		APPROVED	
	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE		NAME	ジャケット型鏡板容器 DTSJ-CTL-24				
-	2024/06/01							
DRAWN	DATE		DWG NO.	3-040436-0				
-	-							
CHECKED	DATE		SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図		
-	-							
APPROVED	DATE		SANKO ASTEC INC.					
-	-							